

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «18» апреля 2022 г. № 995

Регистрационный № 85318-22

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Стандарты частоты FE-5680A

Назначение средства измерений

Стандарты частоты FE-5680A (далее – СЧ) являются квантовыми стандартами частоты рубидиевыми пассивного типа и предназначены для формирования высокостабильных по частоте спектрально чистых синусоидальных сигналов 10 или 5 МГц.

Описание средства измерений

Принцип действия СЧ основан на автоподстройке частоты внутреннего опорного кварцевого генератора к частоте спектральной линии квантового перехода атомов рубидия (стандарты частоты рубидиевые пассивного типа) и формирования высокостабильных сигналов с номинальным значением частоты 10 МГц (по заказу доступны СЧ со значением частоты 5 МГц).

Конструктивно СЧ состоит из СВЧ-резонатора, содержащего рабочую ячейку с атомами Rb⁸⁷, кварцевого генератора, системы фазовой автоподстройки частоты опорного кварцевого генератора, делителя частоты, формирующего требуемую частоту выходного сигнала СЧ, заключенных в едином моноблоке. На тыльной стороне СЧ находятся разъем для подачи питающего напряжения и управления и разъем типа SMA для выходного синусоидального сигнала.

СЧ могут содержать набор дополнительных опций. Информация о дополнительных опциях приведена в руководстве по эксплуатации.

Общий вид СЧ представлен на рисунке 1.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.



Рисунок 1 – Общий вид СЧ

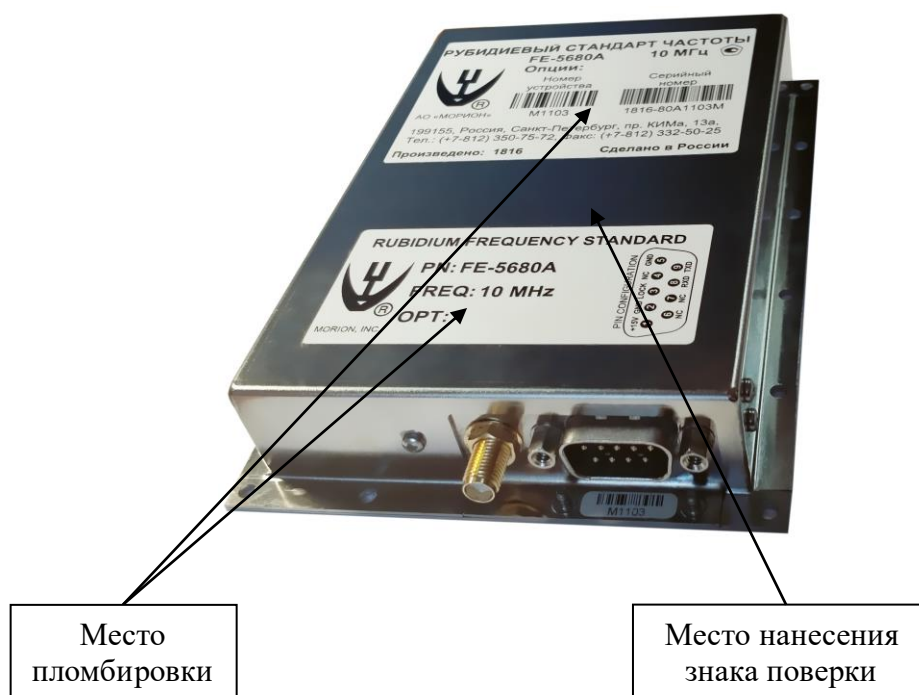


Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки

Программное обеспечение

Программное обеспечение отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение					
	Номер (обозначение опции)					
	3	Стандартное исполнение	28	29	31	31А
Номинальное значение частоты выходного сигнала, Гц	$5 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^7$				
Среднее квадратическое значение напряжения выходного сигнала на нагрузке 50 Ом, В (дБм)	от 0,5 (1,0 для опции 21) до 2,3 (от 7(13 для опции 21) до 20)					
Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте при нормальных условиях эксплуатации	$\pm 2,0 \cdot 10^{-9}$	$\pm 5,0 \cdot 10^{-10}$	$\pm 2,0 \cdot 10^{-10}$	$\pm 2,0 \cdot 10^{-10}$		
Пределы допускаемой дополнительной температурной нестабильности частоты при изменении температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур	$\pm 3,0 \cdot 10^{-10}$					

Продолжение таблицы 1

Наименование характеристики	Значение					
	Номер (обозначение опции)					
	3	Стандартное исполнение	28	29	31	31А
Предел допускаемого среднего квадратического относительного двухвыборочного отклонения частоты при интервале времени измерений $\tau_{изм}$:						
1 с		$1,4 \cdot 10^{-11}$			$8,0 \cdot 10^{-12}$	$5,0 \cdot 10^{-12}$
10 с		$5,0 \cdot 10^{-12}$			$3,0 \cdot 10^{-12}$	$2,0 \cdot 10^{-12}$
100 с		$2,0 \cdot 10^{-12}$			$1,0 \cdot 10^{-12}$	$6,0 \cdot 10^{-13}$

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение									
	Номер (обозначение опции)									
	40	39	38	37	46	Стандартное исполнение		41	42	43
Рабочие условия эксплуатации, температура окружающего воздуха, °С	от	от	от	от	от	от	до	до	до	до
	-55	-40	-30	-20	-10	-5	+50	+55	+60	+65
Параметры электропитания номинального значения 15 В (напряжение постоянного тока), В	от 15 до 18									
Потребляемая мощность Вт, не более:										
– во время включения при номинальном значении напряжения источника питания 15 В, при температуре 25 °С	36									
– в установившемся режиме при номинальном значении напряжения источника питания 15 В, при температуре 25 °С	15									
Габаритные размеры, мм, не более:										
длина	145									
ширина	104									
высота	27									
Масса, кг, не более	0,5									

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации, паспорт, спецификацию и на информационную наклейку.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность СЧ

Наименование	Обозначение	Количество
Стандарт частоты	FE-5680A	1 шт.
Спецификация	-	1 шт.
Паспорт	ГЖКД.468753.002 ПС	1 экз.*
Руководство по эксплуатации	ГЖКД.468753.002 РЭ	1 экз.*

* Документы представляются по требованию заказчика. Электронный вид руководства по эксплуатации доступен в сети Интернет на сайте <https://morion.com.ru/>.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Стандарт частоты FE-5680A. Руководство по эксплуатации. ГЖКД.468753.002 РЭ», раздел 2.2 «Использование стандарта частоты».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к стандартам частоты FE-5680A

Приказ Росстандарта от 31.07.2018 № 1621 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты».

Технические условия ТУ ГЖКД.468753.002. «Стандарт частоты FE-5680A»

Изготовитель

Акционерное общество «Морион» (АО «Морион»)
ИНН 7801016421
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 13А
Телефон +7 (812) 350-75-72
Факс +7 (812) 350-72-90
Web-сайт: www.morion.com.ru
E-mail: morion@morion.com.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Адрес: 141570, Московская область, г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево, промзона ФГУП «ВНИИФТРИ»

Телефон (факс): +7 (495) 526-63-00

E-mail: office@vniiftri.ru

Web-сайт: www.vniiftri.ru

Аттестат аккредитации по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30002-13 от 11.05.2018

